



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,  
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IVA/ 24/PN/2015

Otwock, dnia 12.01 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne, nr spr 24PN 2015 r

Od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski i zapytania :

**1 Pakiet 18**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z **pakietu 18** do odrębnego pakietu np **18A** pozycję 2 i 3 - **Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe** jednorazowego użytku? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

**2 Pakiet 19**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr **19, pozycji nr 1**:Szczoteczki cytologiczne, fierobronchoskopowe, jednorazowe , średnica zewnętrzna 1,8mm,długość włosa 10mm, średnica włosa 2,4 mm, 3,0 mm lub 4,0 mm, rączka o kształcie 3-chpierzścieni, długość robocza 120cm, możliwość wysuwania szczotki z osłonki zewnętrznej na odległość 2- 3cm, sterylna, spełniająca normy obowiązujące w pracowniach endoskopowych

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**3 Pakiet 19**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr **19, pozycji nr 2**:Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów roboczych bronchoskopów, długość szczotki 180cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**4 dot. pak .nr 3 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**5 dot. pak .nr 3 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z nawilżaczem mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**6 Dot. pakiet 12 poz 1,2**

Czy Zamawiający wymaga, żeby pojemniki były dopuszczone do czyszczenia środkami dezynfekującymi oraz sterylizacji w autoklawie 121° C?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**7 Dot. pakiet 12 poz3,4,5**

Czy Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**8. Dot. rozdz. III pkt.1.2 ust.2 SIWZ**

W SIWZ – rozdz. III pkt.1.2 ust.2 Zamawiający prosi o dołączenie do oferty oświadczenia, „iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679tekst ujednolicony na 18.09.2010 ) i jednocześnie wymaga aby „na złożonych dokumentach potwierdzających jakość oferowanych artykułów adnotacji o numerze pakietu i pozycji, których ww. dotyczą”. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających oraz oświadczenia czy wystarczą tylko same dokumenty dopuszczające z adnotacją o numerze pakietu i pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ tj. oświadczenia iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu, natomiast, jeżeli Wykonawca dołączy – nieobowiązkowo dokumenty potwierdzające to z adnotacją o numerze pakietu i pozycji, których ww. dotyczą

**9. Dot. zawarcia umowy**

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

**10. Dot. § 5 ust. 2**

Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu terminu dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, potwierdzamy nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy zał. Nr 4 do SIWZ w § 5 ust. 2 słowa : „...w ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach..”

**11 Dot zad. nr 7 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**12 Dot zad. nr 7**

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy ilość opakowań podać ułamkowo czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, od 0,5 górę ? )

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**13 Dot zad. nr 7**

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia oświadczenia wymaganego w SIWZ w odniesieniu do wskazanego pakietu, gdyż wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy wyrobach med. z 20.05.2010r

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia oświadczenia w przypadku gdy wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy wyrobach med. z 20.05.2010r.

**14. Dot wzoru umowy §8 ust.2b)**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**15 Dot. zapisów umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści :”Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach ( za zrealizowane zamówienie ) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**16 Dot. zapisów umowy**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy poniższej treści :”Strony ustalają, że w wyjątkowych , uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy””

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**17.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie została wszczęta likwidacja wobec Zamawiającego.

### **18 Pakiet 20**

**Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 w pozycji 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych.

Zestaw zawiera igłę o długości 45 mm z możliwością regulacji przedłużenia w zakresie 0-50 mm, strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml, adapter zaworu biopsyjnego. Średnica 22 G, koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości całkowitej 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie wyprofilowany uchwyt z regulacją zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy OLYMPUS, minimalny kanał roboczy 2,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **19.Pakiet 20**

**Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych (zestaw zawiera strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml i igłę wyposażoną w wycięcie do pobierania tkanki z delikatnych okolic płuc o długości 45 mm z możliwością regulacji w zakresie 0-50 mm, średnice 22 G lubi 25 G, koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy OLYMPUS, minimalny kanał roboczy 2,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **20. Pakiet 21**

**Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych.

Zestaw zawiera igłę o długości 45 mm z możliwością regulacji przedłużenia w zakresie 0-50 mm, strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml. Średnica 22 G, koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości całkowitej 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie wyprofilowany uchwyt z regulacją zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy PENTAX, minimalny kanał roboczy 2,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**21.Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów, co ma być potwierdzone fabrycznie umieszczoną przez producenta informacją na opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Tak.

**22.Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu E-600 w rolce o szerokości 110mm, z nadrukiem 100mm oraz marginesami 5mm po każdej stronie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Nie.

**23.Pakiet 4, pozycja 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy dopuszcza zamiennik ?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego .

**24.Pakiet 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchu 1 x użytku o wymiarach 85x115 cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**25.Pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu chirurgicznego o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**26.Pakiet 5, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka chirurgicznego nie posiadającego wstawki przeciwpotnej, ale posiadający możliwość wywinięcia, co tworzy dodatkową warstwę chroniącą przed potem?

Odpowiedź Zamawiającego ;

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**27.Pakiet 5, pozycja 11**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment w danym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**28.Pakiet 5, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu jednorazowego o chłonności 360 ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**29.Pakiet 5, pozycja 13-16**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment w danym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**30.Pakiet 5, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków dentystycznych o wymiarach 48x35 cm z kieszenią o szerokości 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**31.Pakiet 5, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty bez anty poślizgowej folii?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie.

**32.Pakiet 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści mleczny słój typu „tulipan”, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

**33.Pakiet 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 szt. z przeliczeniem ilości na 2134 opakowania ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

**34.Pakiet 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający oczekuje opasek uciskowych zawierających w rolce min. 25 szt. ?


Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

### **35.Pakiet 14, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aktywno-pasywnego drenażu ran pooperacyjnych o poniższej specyfikacji:

- skład zestawu: pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 500 ml oraz dren łączący opcjonalnie zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu
- skalowany co 40 ml płaski mieszek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiającym wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu
- dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemy zaciskowe typu zatraskowego
- jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami Redona o CH 12-36
- drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
- własny, wygodny w użyciu system podwieszania
- worek zbiorczy, skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
- w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka
- tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
- dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi umożliwiające skuteczny i długotrwały drenaż
- sterylny, pakowany podwójnie

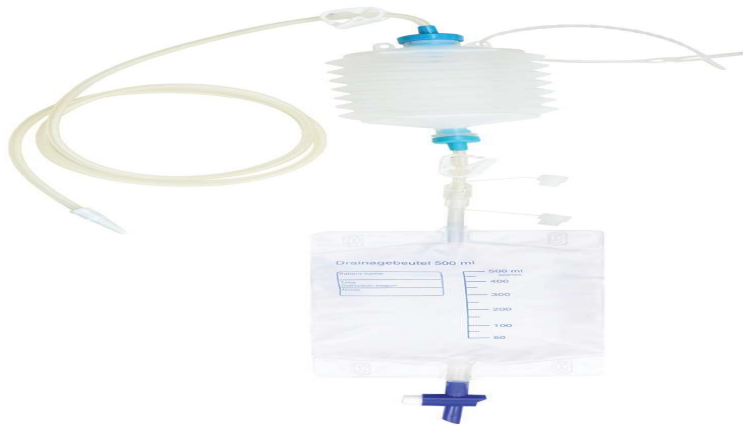

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

### **36.Pakiet 14, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści łączniki wykonane z mlecznego polipropylenu (PP), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **37.Pakiet 15, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr o długości ramion 450 x 180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

### **38 Pakiet 1**

#### **Pozycja 1,2,3,4**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **39. Pozycja 4**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych w opakowania a 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego :



Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

#### **40. Pozycja 7**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk o pojemności 50-60 ml ogólnie stosowanych w Placówkach Służby Zdrowia.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

#### **41. Pozycja 11**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny skalowanej co 0,01 ml.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

#### **42. Pozycja 19**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych 31G (0,25 x 5 mm) oraz  
30G (0,30 x 8 mm)

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

### **Pakiet 3**

#### **43. Pozycja 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza tlenowego do tlenoterapii, pojemnik z wodą sterylną 650 ml.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

#### **44. Pozycja 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza tlenowego do tlenoterapii, pojemnik z wodą sterylną 340 ml.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

#### **45. Pozycja 18,19**

Ze względu na różnice pojemności wody sterylnej zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania wyceny za 10 ml wody z możliwością podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie może zwiększyć grupę wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

## **Pakiet 1 Igły i strzykawki**

### **46.Pozycja 5, 6, 7**

Czy w poz. 5, 6, 7 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują strzykawki Luer z gwintem, jedynymi strzykawkami z gwintem są strzykawki Luer-Lock?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje strzykawkę z gwintem, dalej jak w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

### **47.Pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 strzykawkę do pomp infuzyjnych 50ml kompatybilnych z wymienionymi pompami?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **48.Pozycja 9, 10**

Czy w poz. 9, 10 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi typu Luer, tylko przyrządy do płynów infuzyjnych i krwi Luer-Lock?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje przyrządów do przetoczeń zakończonych gwintem , dalej zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**49.** Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 9 i 10 przyrządy do przetoczeń płynów oraz krwi wykonane były z tworzywa nie zawierającego ftalanów, z zaciskiem rolkowym posiadającym dodatkowy otwór do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **50.Pozycja 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 strzykawki do TBC skalowanej co 0,01 ml z niewtopioną igłą nałożoną na strzykawkę 0,45 x 12?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

### **51. Pozycja 12-18**

Czy Zamawiający wymaga aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie.

### **52. Pozycja 21**

Czy w poz. 21 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują przedłużacze do pomp infuzyjnych typu Luer z gwintem, tylko przedłużacze z gwintem typu Luer-Lock?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje przedłużaczy z gwintem , dalej zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

## **Pakiet 2 Kaniule**

### **53. Pozycja 1a-1g**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1a kaniuli dożylniej 24G, długość 19mm o przepływie 23 ml/min?

**54.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1b kaniuli dożylniej 22G, długość 25mm o przepływie 33 ml/min?

**55.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1c kaniuli dożylniej 20G, długość 32mm o przepływie 65 ml/min?

**56.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1d kaniuli dożylniej 18G, długość 45mm o przepływie 95 ml/min?

**57.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1e kaniuli dożylniej 17G, długość 45mm o przepływie 142 ml/min?

**58.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1f kaniuli dożylniej 16G, długość 45mm o przepływie 200 ml/min?

**59.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1g kaniuli dożylniej 14G, długość 45mm o przepływie 305 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt. Od 53 do 59 :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

## **Pakiet 11**

**60.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 deponator – licznik do igieł jednorazowego użytku i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie.

### **Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 3 i 4**

**61.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni zgodny z art. 122 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili składania oferty przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżane lub podwyższane przez ustawodawcę. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu ***W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna***

Odpowiedź Zamawiającego

Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 4 dopuszcza zmianę ceny w przypadku zmian stawki podatku VAT, a co za tym idzie zmianę ceny brutto.

## PAKIET NR 6

**62. Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**63. Poz. nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety chirurgicznej wykonanej z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, pakowanej w opakowanie wyposażone w jedną dwuczęściową etykietę samoprzylepną, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**64. Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 37,5 x 45 cm lub 50 x 50 cm? Pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**65.** dotyczące zapisów umowy, SIWZ pkt. III podpunkt b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

**66:** dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt. 2 oraz zapisów SIWZ pkt. III podpunkt b: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach umowy paragraf 5 pkt. 2, prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ pkt. III podpunkt b i umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, potwierdzamy nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy zał. Nr 4 do SIWZ w § 5 ust. 2 słowa : „...w ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach..”

**67.** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **pakiet 18 poz. 1** : Ze względu na fakt, że producent nie jest w stanie określić na ile badań wystarczą szczypce wielorazowego użytku ; biorąc pod uwagę , że żywotność narzędzia wielorazowego, zależy w znacznym stopniu od sposobu użytkowania, sterylizacji i przechowywania Czy Zamawiający odstąpi od zapisu : „, możliwość wielokrotnego używania 50 - 70 razy ”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**68.** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **pakietu nr 20 poz 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł aspiracyjnych bez blokady i bez strzykawki podciśnieniowej w komplecie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**69.:** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **pakietu nr 20 poz 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

**70.:** Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Dot pakietu 5

**71** poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha pielęgniarzkiego ochronnego 1x użytku, fizeolina, kolor biały z mankietem w gumkę, gramatura 20g/m<sup>2</sup> wiązane na troki, rozmiar uniwersalny, pakowany po 10 szt na opakowaniu data produkcji, producent

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**72.**poz.4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy komplet chirurgiczny ma być pakowany jako komplet (bluza+ spodnie) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, bluza pakowana osobno, spodnie pakowane osobno.

**73.** poz.5 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła ochronnego 1x użytku, fizeolinowe, gramatura 20g/m<sup>2</sup> kolor zielony w rozmiarze 210x160 , niesterylne, pakowane po 50 szt na opak. data pr. Producent

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**74** poz.11 Prosimy zamawiającego o odstąpienie od oznaczania poziomu ochrony maski w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i odstępuje od wymogu oznaczania poziomu ochrony maski w kolorze pomarańczowym.

## **75. Dotyczy Pakietu 6**

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Zestawu uniwersalnego, zgodnego z poniższym opisem:

Skład zestawu:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm

- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 40 x 40

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, włóknina dwuwarstwowa, laminowana, nieprzemakalna (SPP/PE) chłonna na całej powierzchni, gramatura 60g/m<sup>2</sup>, Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >200cm H<sub>2</sub>O), oraz odporność na rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii, datą ważności i producentem. Zgodność z normą PN-EN 13795 1-3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **76. Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Jednorazowego fartucha chirurgicznego, jałowy, pełno barierowy o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>, zgodny z normą EN 13795 1-3, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej długości rękawów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **77. Pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Foliai operacyjnej w rozmiarze 50 x 45 cm. (opakowanie 10 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **78. Pozycja 6**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Serwetki jałowej do osuszania rąk o wymiarach 40 x 40cm pakowanej po 1 szt. opakowanie papier – folia. Informacje: kod produktu, data ważności, numer serii, producent. Zgodne z normą EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **79. Pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Serwety jałowej, dwuwarstwowej, chłonnej o wymiarach 45 x 45cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

#### **80. Dotyczy Pakietu 10**

##### **Pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Kieliszków w opakowaniach a 75 szt., przeliczenie ilości na 2.134 opakowania i podanie ceny za opakowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy z jednoczesnym przeliczeniem zgodnie z zamawianą ilością .

### **81. Dotyczy Pakietu 11**

Pozycja 1b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnika o pojemności 5l, wysokość 195mm, podstawa 205mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

PAKIET NR 7

**82. POZ.1** Czy zamawiający wymaga aby test przed procesem sterylizacji miał kolor błękitny i w trakcie procesu przebarwił się na kolor czarny? Ułatwi to interpretację wyniku kontroli procesu sterylizacji?

**83. POZ.4** Czy zamawiający wymaga aby test był samoprzylepny? Ułatwi to proces archiwizacji kontroli dezynfekcji i mycia.

**84. POZ.6** Czy zamawiający dopuści test kl.IV?

PAKIET NR 8

Poz. 3 a, b, c, d,e,f,g

**85** Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji z wyraźnie oznaczonym kierunkiem otwierania w postaci piktogramu otwartej torebki umieszczonym tylko od strony folii?

**86.** Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**87.** Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku?

**88.** Czy Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

**89.** Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

**90.** Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m<sup>2</sup> i foli minimum 6 – warstwowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 ::

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**Pakiet nr 6:**

**91.** poz. 1: Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13 795 1-3, o gramaturze 56/m<sup>2</sup>. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE z domieszką polipropylenu. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >200cm H<sub>2</sub>) oraz odporność na rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1).

Skład:

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x 145cm (+/\_5cm)

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm (+/\_10cm)

1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 240 x 150

1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 175 x 170cm(+/\_10cm),

2 ręczniki włókninowe 40x 20cm

1 kieszeń samoprzylepna (2K) 40x 35cm (+/\_5cm) – pakowana osobno poza zestawem

1 taśma samoprzylepna 10x 50cm (+/\_2cm)

2 dwuwarstwowe serwety samoprzylepne 90x 75cm

(+/\_5cm)

na opak. data produkcji,termin przydatności, producent

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**92.** 2. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy



**93. poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej + wzmocnienia 40 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym min. 203 cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**94. poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**95. poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści serwetki do rąk o wymiarach 30 x 30 cm, pakowane pojedynczo a' 1 szt. oraz zbiorczo w karton po 150 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

**96. poz. 5:** Jak należy rozumieć podane ilości, tzn. czy Zamawiający wymaga serwetek pakowanych po a'2 szt., następnie zbiorczo a'2 szt. x 25, czyli w opakowaniu jest 50 szt. serwetek?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 ::

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**97. poz. 5:** Czy wymóg zgodności z normą PN – EN 13 795 nie jest omyłką Zamawiającego?

Powyższa norma nie odnosi się do wyrobów takich jak ściereczki do rąk, a do wyrobów z laminatów i włókien stanowiących elementy obłożenia pola operacyjnego lub odzieży operacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy Pakietu nr 6 poz.5 zgodnie z opisem przedmiotu Zamawiającego

**98. poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 75 cm o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**99. poz. 8:** Czy Zamawiający zwiększy tolerancję rozmiaru „na plus” do 15%?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**Pakiet 8:**

100.poz. 3c: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100 m z przeliczeniem wymaganej ilości? Wg naszej wiedzy rynkowej rękawy z zakładką o długości 200 m nie są oferowane przez żadnego z wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

101.poz. 3f: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 200 m z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**Pakiet 9:**

102.poz. 1: Czy Zamawiający w przypadku serwety z otworem o średnicy 5 cm z rozcięciem m dopuści tolerancję rozmiaru „na plus” 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 ::

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

**Pytania dot. treści umowy**

103.Czy za dni robocze w rozumieniu umowy rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .